

Kyushu Multi Slice CT Users Meeting in OITA

開催のご案内 — 実施要綱 —

1. 日時	2019年3月9日(土) 14:30~18:00 (開場 14:00)
2. 会場	ホルトホール大分 2F (〒870-0839 大分県大分市 金池南 1 丁目 5-1)
3. 定員	80名(キヤノン製CT装置以外をお使いの方も参加可能です。) ※収容人数に限りがございますので、収容人数を超えた場合は、申し訳ございませんが 先着順とさせていただきます。
4. 申込方法	出席申込書を FAX または、ホームページにて受け付けます。
5. 申込先	FAX : 092-575-2748 又は、 ホームページ : http://kmsctum.kenkyuukai.jp/information/index.asp? (「九州 MSCT ユーザー会」で検索をお願い致します。)
6. 申込締切	2019年3月6日(水)
7. 内容	<p style="text-align: center;">テーマ すぐに使える！各施設の再構成実践法！</p> <ul style="list-style-type: none">■ 開催挨拶・アンケート報告 (14:30~14:40)■ メーカー情報提供 (14:40~15:00) 演者：キヤノンメディカルシステムズ㈱ CT 担当者■ 施設発表 (15:00~16:00) 「ハード面が画質に与える影響に関して(仮)」 演者：産業医科大学病院 大石 芳貴 先生 「バージョンの異なる装置間における画質の考え方」 演者：大分大学医学部附属病院 岩田 直浩 先生 「造影検査における BHC 関数の画質への影響」 演者：大分県厚生連 鶴見病院 河野 実月 先生 ----- 休憩 (16:00~16:15) -----■ 施設発表 (16:15~17:15) 「元画像から 3D まで — 整形領域の関数・パラメータ選択—」 演者：社会医療法人 共愛会 戸畑共立病院 田原 琢朗 先生 「頭部 CTA に対する再構成の変遷～変わる画質と変えないこだわり～」 演者：社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 本田 美貴 先生 「メーカーが異なる CT 装置の画質調整」 演者：大分県立病院 西嶋 康二郎 先生 ----- 休憩 (17:15~17:30) -----■ パネルディスカッション (17:30~17:50) 「各領域単純 CT の画質調整について」 ※各ご発表施設より、頭部・胸部・腹部単純画像をご提示頂き、その撮影条件、 再構成条件設定の背景をディスカッションして頂く予定です。■ 次回当番世話人挨拶 (17:50~18:00)
8. その他	・参加費は無料です。交通費は各自ご負担となります。 ・「日本 X 線 CT 専門技師認定機構 認定講習会 II-3 半日」取得予定

参加人数把握のため事前申込制とさせて頂いております。お手数ですが、参加される方は裏面の申込書にご記入の上 FAX いただくか、「九州 MSCT ユーザー会ホームページ」からお申し込みをお願い致します。
開催案内をメールでお受け取りご希望の方は、ホームページより登録が可能となっておりますのでご利用下さい。

⇒ FAX 番号 : 092-575-2748 (九州支社 山岸宛て)


CT ユーザー会 出席申込書	
ご施設名	
ご芳名	

申込期限 : 2019年3月6日(水)までお願い致します。

■会場アクセス

ホルトホール大分

(住所 : 〒870-0839 大分県大分市 金池南 1丁目 5-1)

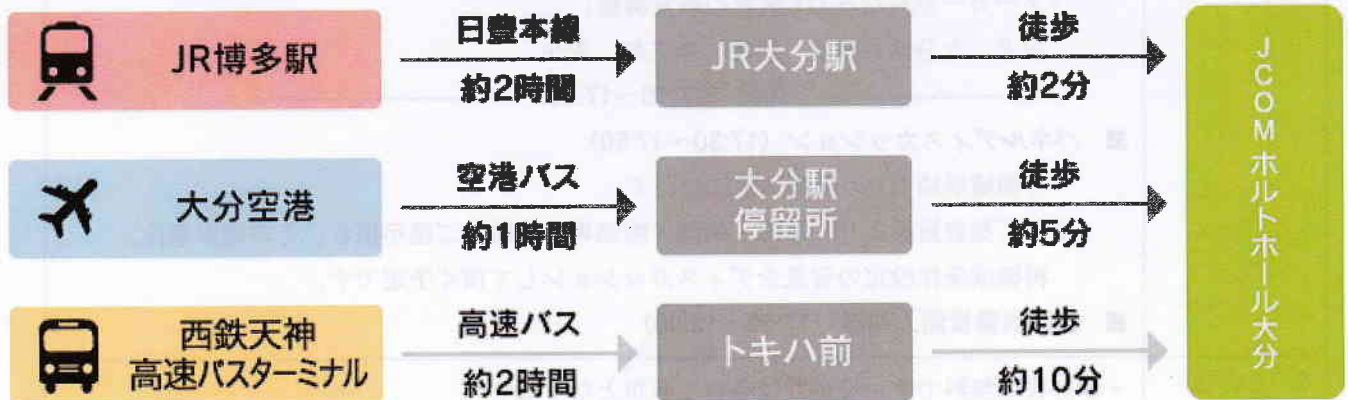

【お車をご利用の方】

会場にも駐車場はございますが、割引等はありません。なるべく公共交通機関をご利用下さいませよう、お願い申し上げます。

(お問合せ先)

キャノンメディカルシステムズ株式会社 九州支社 営業推進部 山岸 悠樹
TEL 092-575-2715 E-mail yuki1.yamagishi@medical.canon